

Zertifikat

Das Prüflabor: **GWA mbH**
NL Institut für Wasser- und Umweltanalytik

An der Ohratalsperre
99885 Luisenthal

mit der Teilnehmernummer **074** hat am

LÜRV B8 Chlorophyll in Oberflächenwasser

Mai 2016

teilgenommen.

Folgende Parameter umfasste der Ringversuch:

Chlorophyll a, Phaeopigment

Folgende Parameter hat das Labor gemessen:

Chlorophyll a, Phaeopigment

Folgende Parameter hat das Labor unter Einhaltung der Rahmenbedingungen erfolgreich bestimmt:

Chlorophyll a, Phaeopigment


Die Einzelergebnisse aller gemessenen Parameter sind aus der Anlage zu diesem Zertifikat ersichtlich.



A. Simon
Ringversuchsleiter

Anlage zum Zertifikat
LÜRV B8 Chlorophyll in Oberflächenwasser
für das Laboratorium

074

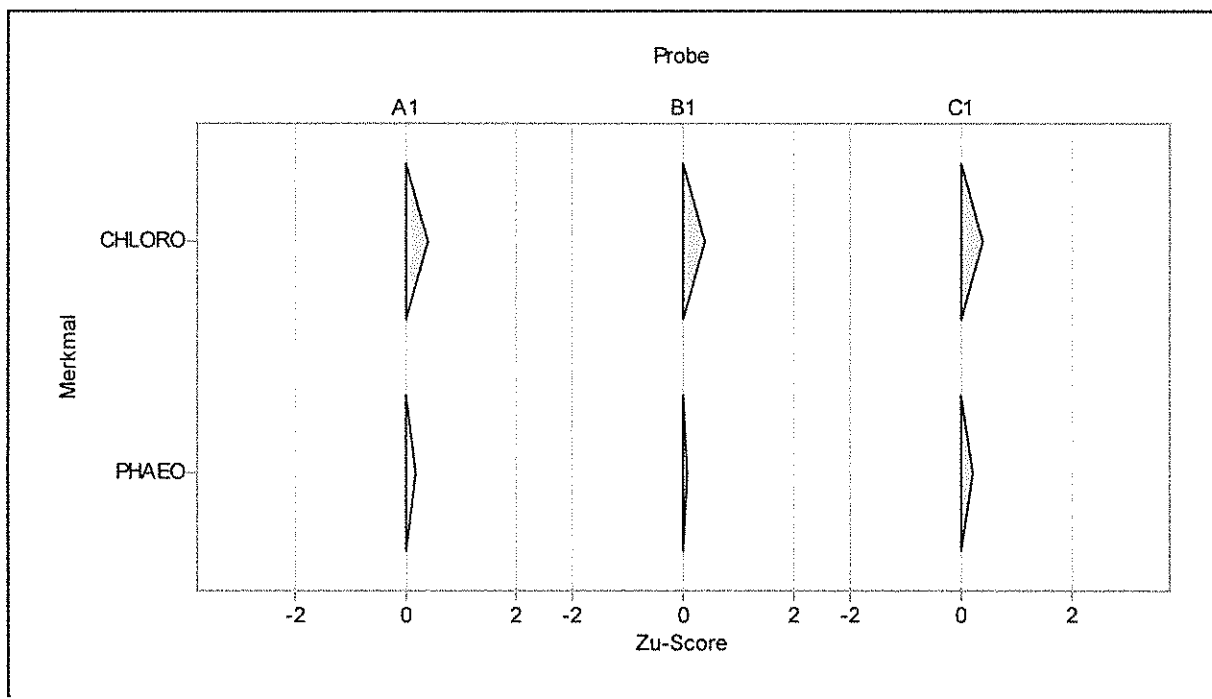

Probe	Probencode	Merkmal	Einheit	Sollwert	Laborwert	Zu-Score
A1	0049	Chlorophyll a	µg/l	60,8	64,3	0,4
A1	0049	Phaeopigment	µg/l	24,8	26,8	0,2
B1	0227	Chlorophyll a	µg/l	32,7	34,4	0,4
B1	0227	Phaeopigment	µg/l	13,4	14,2	0,1
C1	0084	Chlorophyll a	µg/l	10,8	11,4	0,4
C1	0084	Phaeopigment	µg/l	5,4	6	0,2